



Codice Dianflex: 242-RM508

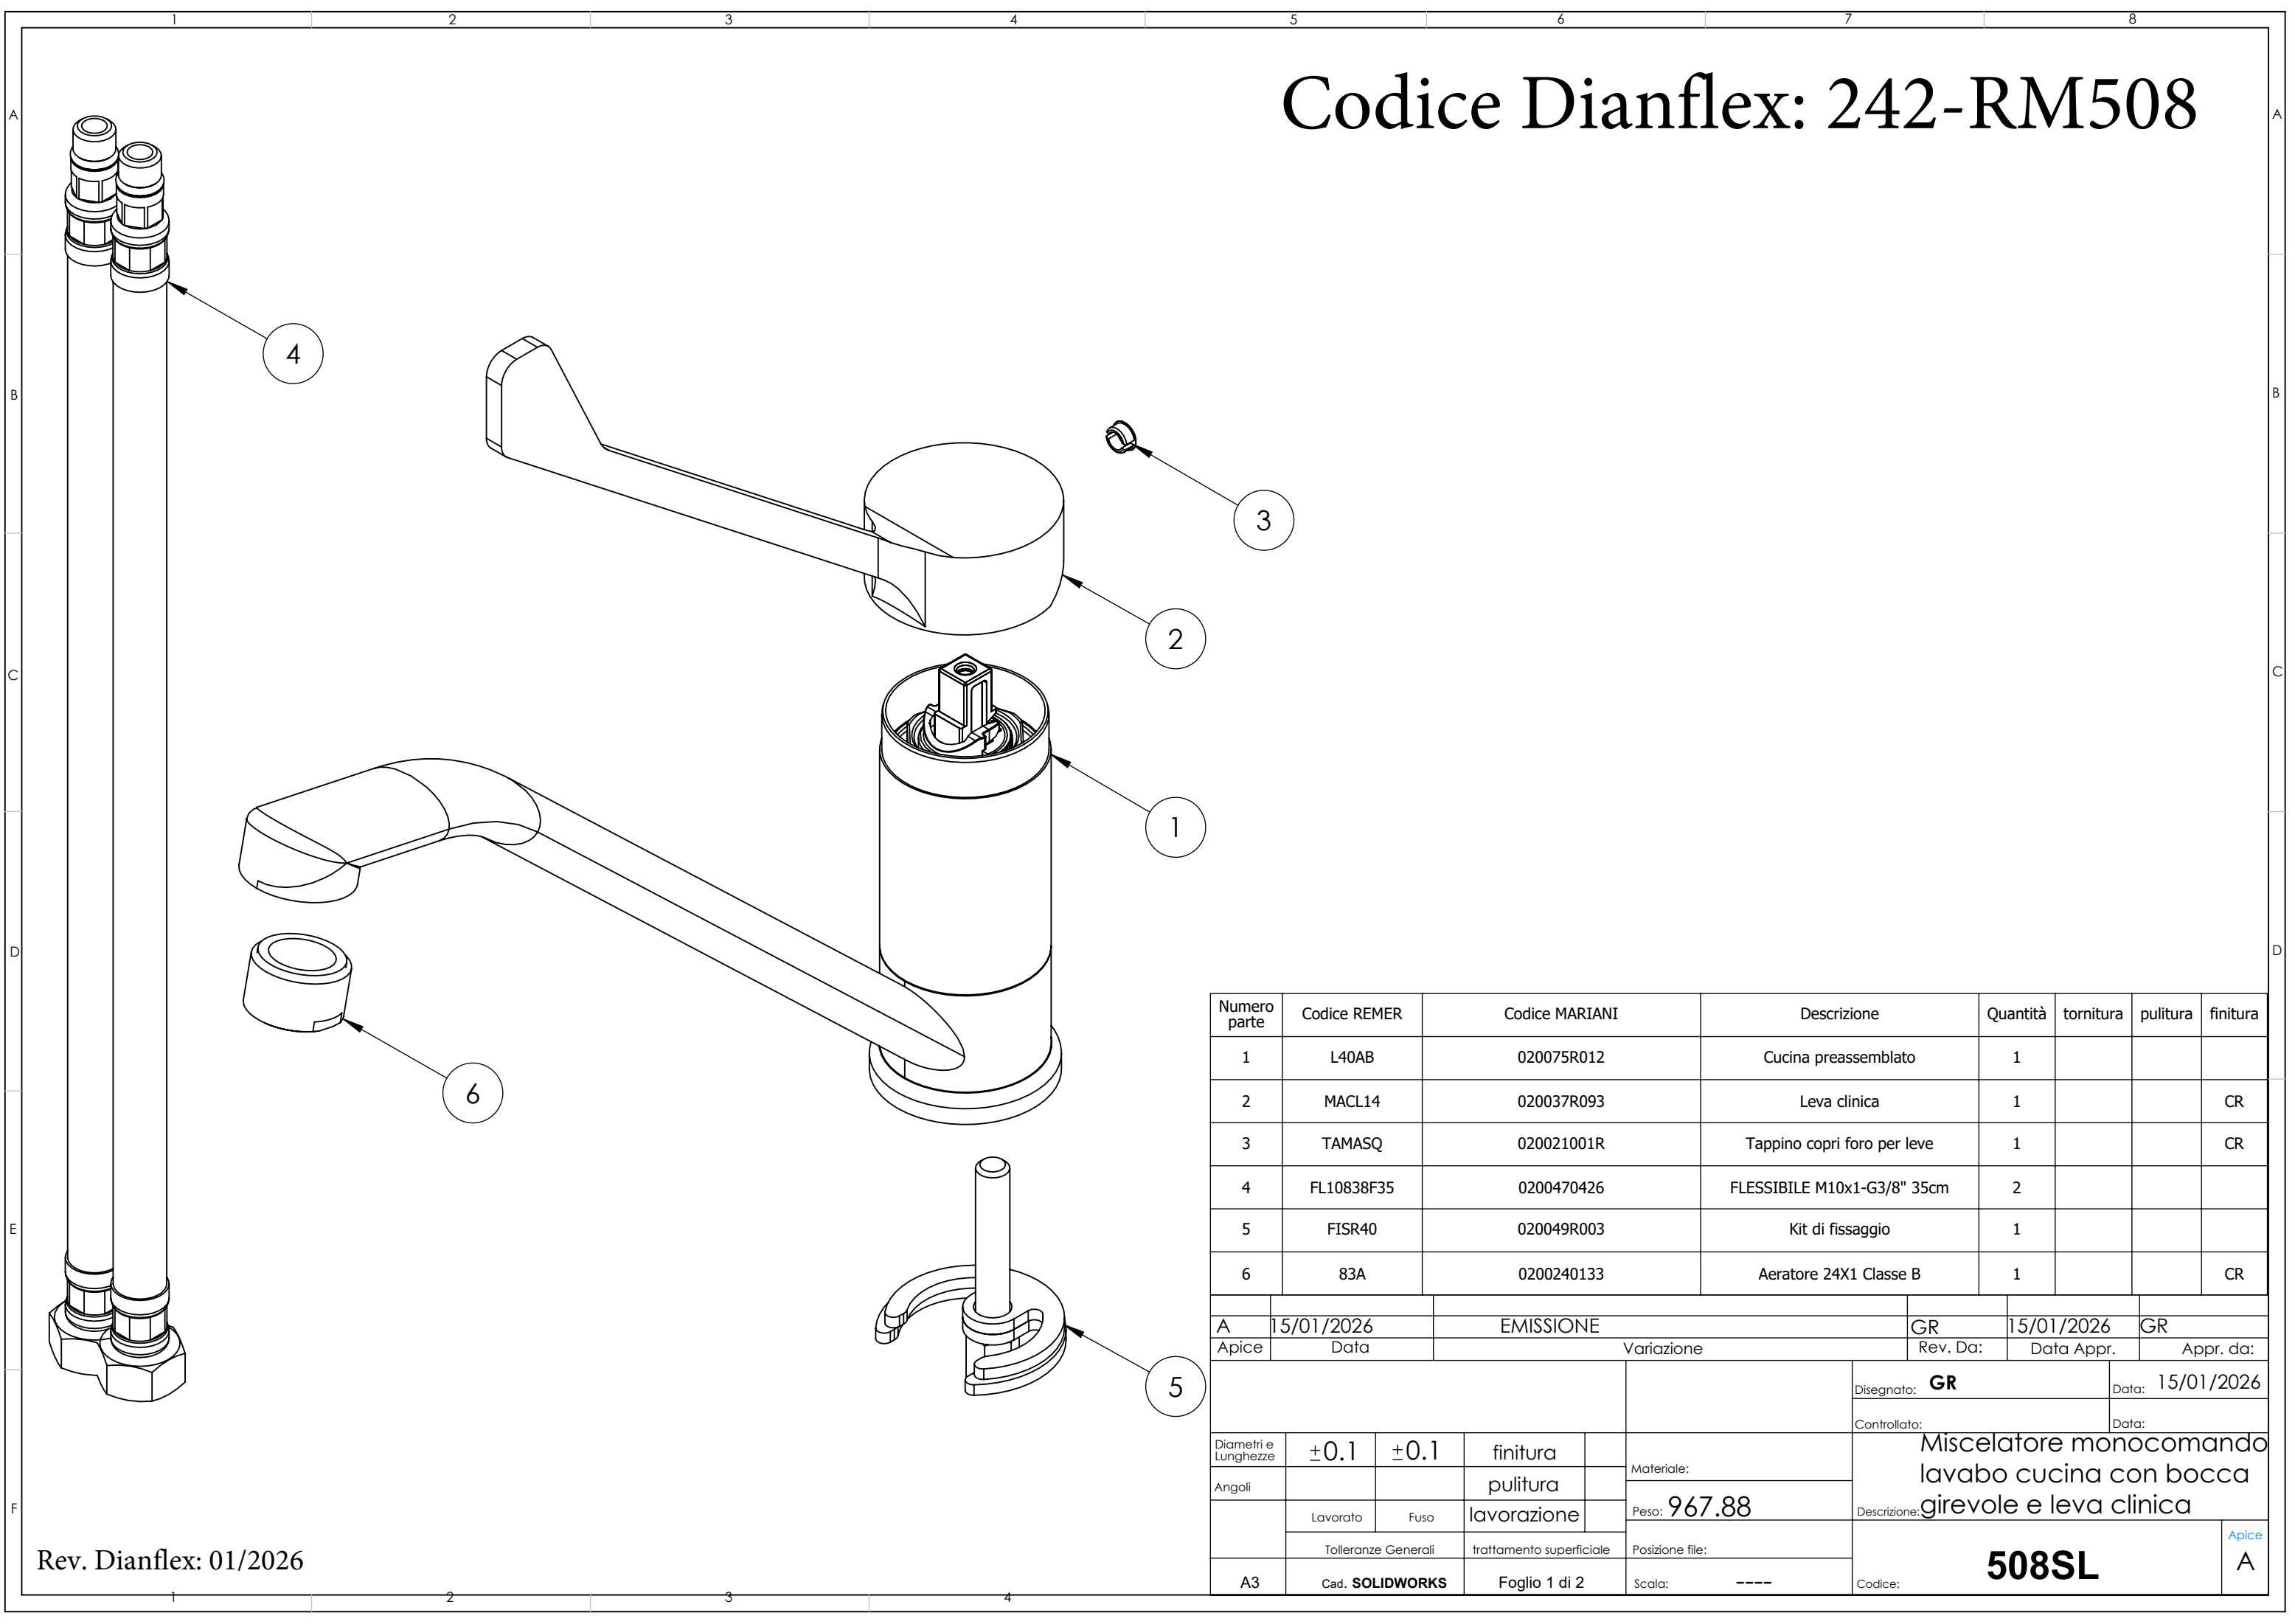

| Numero parte         | Codice REMER           |                     | Codice MARIANI |                          | Descrizione                                                                   | Quantità | tornitura        | pulitura | finitura  |
|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------|
| 1                    | L40AB                  |                     | 020075R012     |                          | Cucina preassemblato                                                          | 1        |                  |          |           |
| 2                    | MACL14                 |                     | 020037R093     |                          | Leva clinica                                                                  | 1        |                  |          | CR        |
| 3                    | TAMASQ                 |                     | 020021001R     |                          | Tappino copri foro per leve                                                   | 1        |                  |          | CR        |
| 4                    | FL10838F35             |                     | 0200470426     |                          | FLESSIBILE M10x1-G3/8" 35cm                                                   | 2        |                  |          |           |
| 5                    | FISR40                 |                     | 020049R003     |                          | Kit di fissaggio                                                              | 1        |                  |          |           |
| 6                    | 83A                    |                     | 0200240133     |                          | Aeratore 24X1 Classe B                                                        | 1        |                  |          | CR        |
|                      |                        |                     |                |                          |                                                                               |          |                  |          |           |
| A                    | 15/01/2026             |                     | EMISSIONE      |                          |                                                                               | GR       | 15/01/2026       |          | GR        |
| Apice                | Data                   |                     | Variazione     |                          |                                                                               | Rev. Da: | Data Appr.       |          | Appr. da: |
|                      |                        |                     |                |                          | Disegnato: <b>GR</b>                                                          |          | Data: 15/01/2026 |          |           |
|                      |                        |                     |                |                          | Controllato:                                                                  |          | Data:            |          |           |
| Diametri e Lunghezze | ±0.1                   | ±0.1                | finitura       |                          | Miscelatore monocomando<br>lavabo cucina con bocca<br>girevole e leva clinica |          |                  |          |           |
| Angoli               |                        |                     | pulitura       |                          |                                                                               |          |                  |          |           |
|                      |                        | Lavorato            | Fuso           | lavorazione              |                                                                               |          |                  |          |           |
|                      |                        | Tolleranze Generali |                | trattamento superficiale | Posizione file:                                                               |          | <b>508SL</b>     |          |           |
| A3                   | Cad. <b>SOLIDWORKS</b> |                     | Foglio 1 di 2  |                          | Scala: ----                                                                   |          |                  |          |           |
|                      |                        |                     |                |                          | Codice:                                                                       |          | Apice<br>A       |          |           |

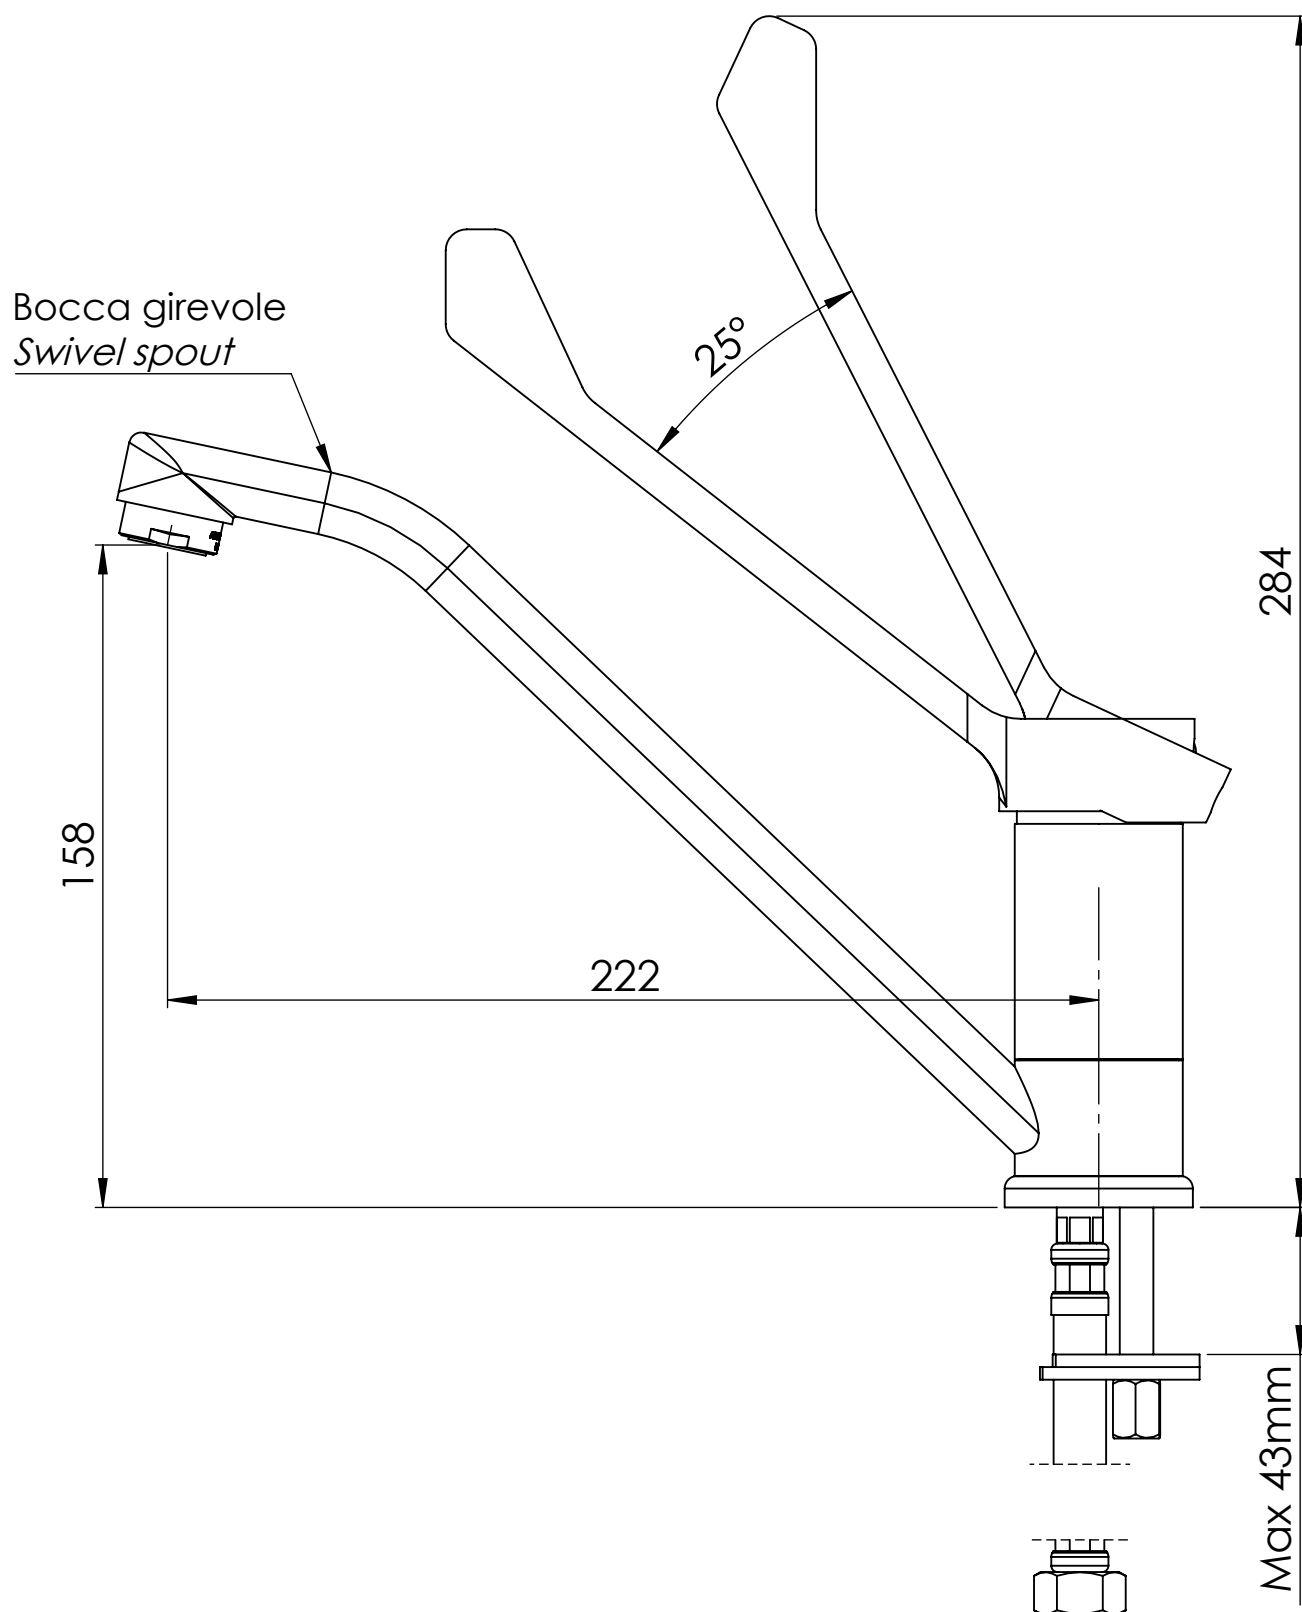

|              |                                                                         |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Serie        | Cod. articolo                                                           | <b>508SL</b> |
| Descrizione: | Miscelatore monocomando lavabo cucina con bocca girevole e leva clinica |              |
| Description: | Single lever kitchen mixer with swivel spout                            |              |